


**Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne**  
**LABORATÓRIÁ RÚVZ**

Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, fax 032/6521997

Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia

Tel.: 032/6509535, email: tn.hlm@uvzs.sk

Protokol č. 237/22/A

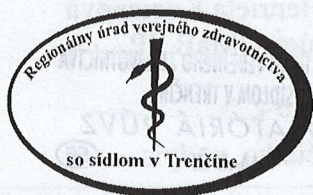

Reg. No. 067/S-153

A – akreditovaná metóda

N – neakreditovaná metóda

## PROTOKOL O SKÚŠKE č. 237/22/A

Dátum prevzatia vzorky vodomeru/vodomerov: 15.2.2022

Dátum odberu technologickej vody (N): 15.2.2022

Miesto výkonu laboratórnych činností: Laboratóriá RÚVZ Trenčín

Meno a adresa zákazníka, zadávateľ Sensus Slovensko a.s., nám. A Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá

Vodomery dodal: Sensus Slovensko a.s., nám. A Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá

Vodomery odobral/prevzal (N): odobral zákazník / prevzala: Marčeková - RÚVZ Trenčín

| Kód vzorky | Predmet skúšky                          | A/N | Identifikácia použitej metódy |
|------------|-----------------------------------------|-----|-------------------------------|
| 445-452    | Technologická voda (výplach z vodomeru) | N   | ŠPP 40/III                    |

### MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIE

Dátum vykonania skúšky:  
15.2.2022 – 21.2.2022

| Kód vzorky | Technologická voda z vodomeru č. | Objem získanej technologickej vody v ml | Ukazovateľ (jednotka)                    | Výsledok | A/N | Identifikácia použitej metódy | Neistota stanovenia |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----|-------------------------------|---------------------|
| 445        | 420-01-SPT1-1502 22              | 50                                      | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml) | 0        | A   | ŠPP9/III                      | -                   |
| 446        | 420-02-SPT1-1502 22              | 50                                      | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml) | 0        | A   | ŠPP9/III                      | -                   |
| 447        | 420-03-A2-1502 22                | 50                                      | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml) | 0        | A   | ŠPP9/III                      | -                   |
| 448        | 420-04-A2-1502 22                | 50                                      | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml) | 0        | A   | ŠPP9/III                      | -                   |
| 449        | PT1 120 1502 1230                | 50                                      | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml) | 0        | A   | ŠPP9/III                      | -                   |
| 450        | PT1 120 1502 1231                | 50                                      | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml) | 0        | A   | ŠPP9/III                      | -                   |
| 451        | PT2 120 1502 1232                | 50                                      | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml) | 0        | A   | ŠPP9/III                      | -                   |
| 452        | PT2 120 1502 1234                | 50                                      | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (KTJ/16ml) | 0        | A   | ŠPP9/III                      | -                   |



# Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne LABORATÓRIÁ RÚVZ

Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, fax 032/6521997

Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia

Tel.: 032/6509535, email: tn.hlm@uvzs.sk

Protokol č. 237/22/A


Protokol o skúške vyhotovil:

Meno: Iveta Fröhbauerová

Dátum: 21.2.2022

Za správnosť výsledkov zodpovedá:

Meno: MVDr. Henrieta Kocianová



Protokol schválil

MVDr. Henrieta Kocianová

vedúca OMaB ŽP

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

SO SÍDLOM V TRENČÍNE

LABORATÓRIÁ RÚVZ

pečiatka, podpis

56

Uvedené výsledky sú platné len pre predmet skúšky dodanej laboratóriu. Kopírovanie častí protokolu bez písomného súhlasu vedúceho nie je dovolené. Meradlá a meracie zariadenia použité na analýzy boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov. Údaje poskytované zákazníkom sú uvedené v hlavičke. Laboratórium OMaB ŽP odmieta zodpovednosť, ak informácie dodané zákazníkom môžu mať vplyv na platnosť výsledkov.

Vysvetlivky:

RÚVZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva

OMaB ŽP Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia

N neakreditovaná metóda

ŠPP

A

štandardný pracovný postup

akreditovaná metóda

Koniec protokolu

| Číslo vzorky | Technologická voda (výplach z vodomeru) | Výsledok | Metóda | Identifikácia použitej metódy | Podpis |
|--------------|-----------------------------------------|----------|--------|-------------------------------|--------|
| 445          | 1302-01-SP71-1302-01                    | 0        | A      | SP71/III                      |        |
| 446          | 1302-02-SP71-1302-02                    | 0        | A      | SP71/III                      |        |
| 447          | 1302-03-A3-1302-03                      | 0        | A      | SP71/III                      |        |
| 448          | 1302-04-A3-1302-04                      | 0        | A      | SP71/III                      |        |
| 449          | 1302-05-A3-1302-05                      | 0        | A      | SP71/III                      |        |
| 450          | 1302-06-A3-1302-06                      | 0        | A      | SP71/III                      |        |
| 451          | 1302-07-A3-1302-07                      | 0        | A      | SP71/III                      |        |
| 452          | 1302-08-A3-1302-08                      | 0        | A      | SP71/III                      |        |